


componenten (A en B). Na de polymerisatie wordt de positioner met slijpelementen bewerkt. Het oppervlak kan geboend of met de Odontosil 2K Lack gecoat worden.

Reiniging / desinfectie

De afgewerkte positioner kan worden ontsmet met ontsmettende middelen voor tandheelkundige siliconen die gewoonlijk in standartspraktijken en tandtechnische laboratoria worden gebruikt.

Mengen

De A- en B-component bevinden zich elk in een kamer van de dubbele cartridge. De afsluitkant van de dubbele cartridge wordt door links te draaien verwijderd en vervangen door een mengcanule. Vervolgens wordt de dubbele cartridge in een injector geplaatst. Door de hefboom van de injector te bedienen worden de beide componenten in de richting van de mengcanule bewogen. De mengcanule vermindert A- en B-component en de chemische reactie tussen de beide componenten begint.

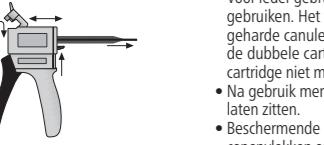

Verwerking

Directe aanmaak: Het set-upmodel wordt tezamen met het model van de tegenoverliggende kaak in een articulator vastgezet. Bij aanmaak van de positioner wordt de articulator derwijze ingesteld dat de beide kaken ongeveer 2,5–3 mm ten opzichte van elkaar opengepers zijn. Met de injector en mengcanule wordt Odontosil op de tandenrijen en in de tandvleesgedeelten gesmeerd. Nadien wordt de articulator tot aan de opensperring gesloten. De polymerisatie gescheelt bij kamertemperatuur. Om ingesloten lucht uit het silicone te verwijderen wordt polymerisatie onder druk (min. 3 bar) aanbevolen. Na 40 minuten kan de uitgeharde positioner van het model losgemaakt worden en vervolgens met slijpelementen bewerkt. Voor het coaten van de positioner wordt Odontosil 2K Lack aanbevolen.

Buiten bereik van kinderen bewaren!

Informatie bij eenmalig gebruik
In linea di principio l'applicazione è indipendente dall'età, ma di solito viene effettuata a partire da circa 14 anni. Il ciclo di vita del posizionatore è di 6–12 mesi, in caso di utilizzo quotidiano di 2 ore.

Gruppo di pazienti target
In linea di principio l'applicazione è indipendente dall'età, ma di solito viene effettuata a partire da circa 14 anni. Il ciclo di vita del posizionatore è di 6–12 mesi, in caso di utilizzo quotidiano di 2 ore.

Afvoer

Afvoer van de inhoud / container overeenkomstig de plaatwijze / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Utenti destinatari

Dentista, orthodontista, laboratori odontotecnici. Gli elasto-positionatori ortodontici possono essere realizzati esclusivamente per il produttore.

Waarschuwingen

Dentista, orthodontista, laboratori odontotecnici. Gli elasto-positionatori ortodontici possono essere realizzati esclusivamente per il produttore.

Ernstige incidenten

Odontosil è un silicone trasparente chiaro, resistente agli strappi, vulcanizzante per addizione, in doppie cartucce, per la realizzazione di posizionatori ortodontici. Il posizionatore è utilizzato per condurre i denti nella posizione corretta. La polimerizzazione del silicone avviene a temperatura ambiente.

Cuvette aangebracht.

De verdere werkstappen dienen zoals bij de directe aanmaak uitgevoerd te worden.

Het materiaal werd speciaal voor het dentale bereik ontwikkeld en moet volgens de gebruiksaanwijzingen verwerkt worden. Voor schade die ontstaan door ander of foutief gebruik en door niet juiste verwerkingswijzen draagt de fabrikant geen verantwoordelijkheid. Bovendien is de fabrikant verplicht het materiaal, op zijn

gebruiks mogelijkheden en voor welke toepassingen / doeleinden het geschikt is te onderzoeken, vooral ook wanneer deze niet vermeld zijn in de gebruiksaanwijzing.

Il numero di lotto e la data di scadenza sono indicati sia all'esterno della confezione, sia sul prodotto. Per reclami relativi al prodotto indicare sempre il numero di lotto. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza.

Questo prodotto è stato sviluppato per essere impiegato in campo dentale ed il suo impiego deve avvenire rispettando le istruzioni d'uso. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni risultanti da utilizzi diversi dal campo d'applicazione o per mancata osservanza delle istruzioni d'uso.

L'utilizzatore è tenuto a verificare sotto propria responsabilità l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, soprattutto nel caso di campi d'utilizzo non esplicitamente indicati nelle istruzioni d'uso.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do lote. Não utilize o produto após expirado o prazo de validade.

O produto foi desenvolvido para uma utilização odontológica e tem de ser utilizado de acordo com as instruções de utilização. O número do lote e o prazo de validade encontram-se na embalagem exterior e no produto. Em caso de reclamações sobre o produto, indique sempre o número do l

Zweckbestimmung
Additivernetzendes Silikon zur Anfertigung von kieferorthopädischen Elastostpositionern

Indikation

Zur Herstellung von kieferorthopädischen Geräten, um die Zähne in eine endgültige Position zu bringen. Das Indikationsgebiet umfasst Elastbehandlungsgeräte zur Feineinstellung der Zähne nach Multibandbehandlung. Aufgrund der hohen Elastizität ist ein Bewegen der Zähne auch ohne vorherige Multibandbehandlung möglich.

Kontraindikation

Bei Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe darf das Produkt nicht angewendet werden. Unerwünschte Nebenreaktionen sind bei sachgerechter Verarbeitung und Anwendung nicht zu erwarten. Immunreaktionen (z. B. Allergien) oder örtliche Missempfindungen (z. B. mechanische Reizungen der Mundschleimhaut) können jedoch prinzipiell nicht ausgeschlossen werden. Sollten entsprechende Reaktionen auftreten, Gebrauch einstellen. Sollten Ihnen unerwünschte Nebenwirkungen - auch in Zweifelsfällen - bekannt werden, bitten wir in jedem Fall um Mitteilung unter möglichst genauer Beschreibung der Begleitumstände und Symptome. Wir gehen jedem Hinweis nach.

Patientengruppe

Direkte Herstellung: Das Setup-Modell wird zusammen mit dem Gegenkiefermodell in einem Artikulator fixiert. Beim Herstellen des Positioners wird der Artikulator mit (Wechsel Milchzähne zu bleibenden Zähnen, vollständiges bleibendes Gebiss) wird die kieferorthopädische Behandlung mittels Silikon-Positioner aus Odontosil 50 bzw. Odontosil 60 nicht empfohlen.

Patientenzielgruppe

Prinzipiell ist die Anwendung zwar altersunabhängig, aber in der Regel wird sie erst ab ca. 14 Jahren durchgeführt. Die Lebensdauer des Positioners beträgt 6–12 Monate bei einer täglichen Tragedauer von 2 Stunden.

Vorgesehene Anwender

Zahnarzt/-ärztin, Kieferorthopäde/in, Dentallabore. Kieferorthopädische Elastostpositioner dürfen nur von qualifizierten Personen hergestellt werden. Zur Beschichtung des Positioners wird der Odontosil 2K Lack empfohlen.

Produktbeschreibung

Odontosil ist ein klar-transparentes, reißfestes, additivernetzendes Silikon in Doppelkartuschen zur Herstellung von kieferorthopädischen Positionern. Mittels des Positioners werden die Zähne in die korrekte Lage bewegt. Die Vernetzung des Silikons findet bei Raumtemperatur durch Vermischen der beiden Komponenten (A und B) statt. Nach der Polymerisation wird der Positioner mit Schleifkörpern bearbeitet. Die Oberfläche kann weiteren Arbeitsschritte unterliegen.


Chargennummer / Haltbarkeitsdatum

Die Chargennummer und das Haltbarkeitsdatum befinden sich sowohl auf der Außenverpackung als auch auf dem Produkt. Bei Beanstandungen des Produktes bitte immer die Chargennummer angeben. Verwenden Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums.

ponenten (A und B) statt. Nach der Polymerisation wird der Positioner mit Schleifkörpern bearbeitet. Die Oberfläche kann weiteren Arbeitsschritte unterliegen.

Anmischen

Die A- und B-Komponente befinden sich jeweils in einer Kammer der Doppelkartusche. Die Verschlusskappe der Doppelkartusche wird durch eine Linksdrehung entfernt und durch eine Mischkanüle ersetzt. Anschließend wird die Doppelkartusche in einen Injektor eingesetzt. Durch die Betätigung des Injektor-Hebels werden die beiden Komponenten in Richtung Mischkanüle bewegt. Die Mischkanüle vermischt A- und B-Komponente und die chemische Reaktion zwischen den beiden Komponenten setzt ein.

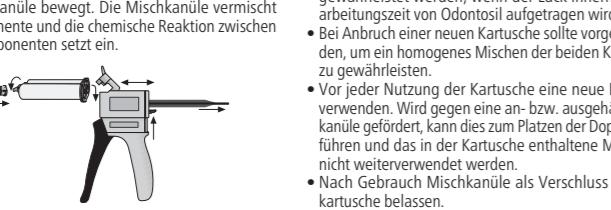

Verarbeitung

Indirekte Herstellung: Das Setup-Modell wird zusammen mit dem Gegenkiefermodell in einem Artikulator fixiert. Beim Herstellen des Positioners wird der Artikulator mit (Wechsel Milchzähne zu bleibenden Zähnen, vollständiges bleibendes Gebiss) wird die kieferorthopädische Behandlung mittels Silikon-Positioner aus Odontosil 50 bzw. Odontosil 60 nicht empfohlen.

Target Patient Group

Althothing application is not dependent on age in principle, it is generally first done from the age of approx. 14. The lifespan of the positioner is 6–12 months with a daily wearing period of 2 hours.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Owing to the physical properties, the cured Odontosil can only be used for one positioner.

Hinweis zum einmaligen Gebrauch

Die Lebensdauer des Positioners beträgt 6–12 Monate bei einer täglichen Tragedauer von 2 Stunden.

Intended users

Indirect production: For indirect production, a positioner is shaped from wax. The wax positioner is embedded into a cuvette using plaster. We recommend the use of hard stone (ISO 6873, type 3) or super hard stone for moulds (ISO 6873, type 4). Once the plaster has set, the wax is melted out with hot water. The resulting hollow form should be treated with an alginate isolate. Odontosil is applied into the hollow form at room temperature as a result of mixing of the two components (ISO 6873, type 3) or super hard stone for moulds (ISO 6873, type 4). The cire se fonde avec de l'eau chaude pour libérer la forme creuse obtenue devrait être traitée avec un isolant d'alginate. Odontosil est appliquée dans le creux de la cuvette au moyen d'un injecteur et d'un embout mezcladora. La forme hueca que se obtiene debe tratarse con un aislante de alginate. Odontosil se aplica en la forma hueca de la cubeta mediante un inyector y una punta mezcladora. Lleve a cabo los pasos sucesivos del trabajo igual que en la fabricación directa.

Hinweis

Odontosil ist ein klar-transparentes, reißfestes, additivernetzendes Silikon in Doppelkartuschen zur Herstellung von kieferorthopädischen Positionern. Mittels des Positioners werden die Zähne in die korrekte Lage bewegt. Die Vernetzung des Silikons findet bei Raumtemperatur durch Vermischen der beiden Komponenten (A und B) statt. Nach der Polymerisation wird der Positioner mit Schleifkörpern bearbeitet. Die Oberfläche kann weiteren Arbeitsschritten unterliegen.


Batch number / use-by date

Das Produkt wurde für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und muss gemäß der Gebrauchsinformation angewendet werden. Es darf nicht auf andere Anwendungen ausgedehnt werden. Bei Beanstandungen des Produktes bitte immer die Chargennummer angeben. Verwenden Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums.

einer Mischkanüle in die Hohlform der Küvette appliziert. Die weitere Arbeitsschritte sind wie bei der direkten Herstellung des Positioners.

Reinigung / Desinfektion

Die Desinfektion des fertiggestellten Positioners kann mit in der Zahnarztpraxis und zahntechnischen Labor gebräuchlichen Desinfektionsmitteln für Dentalsilikone durchgeführt werden. Die zwei Komponenten werden nach dem Absetzen des Injektor-Hebels aus der Doppelkartusche entfernt und durch eine Mischkanüle ersetzt. Anschließend wird die Doppelkartusche in einen Injektor eingesetzt. Durch die Betätigung des Injektor-Hebels werden die beiden Komponenten in Richtung Mischkanüle bewegt. Die Mischkanüle vermischt A- und B-Komponente und die chemische Reaktion zwischen den beiden Komponenten setzt ein.

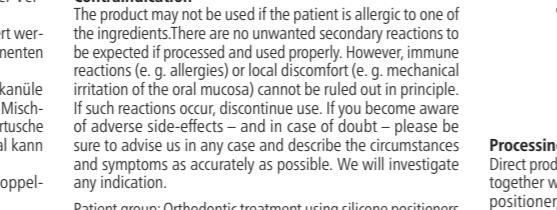

Intended use

Die Desinfektion des fertiggestellten Positioners kann mit in der Zahnarztpraxis und zahntechnischen Labor gebräuchlichen Desinfektionsmitteln für Dentalsilikone durchgeführt werden. Die zwei Komponenten werden nach dem Absetzen des Injektor-Hebels aus der Doppelkartusche entfernt und durch eine Mischkanüle ersetzt. Anschließend wird die Doppelkartusche in einen Injektor eingesetzt. Durch die Betätigung des Injektor-Hebels werden die beiden Komponenten in Richtung Mischkanüle bewegt. Die Mischkanüle vermischt A- und B-Komponente und die chemische Reaktion zwischen den beiden Komponenten setzt ein.

Indication for use

Die Desinfektion des fertiggestellten Positioners kann mit in der Zahnarztpraxis und zahntechnischen Labor gebräuchlichen Desinfektionsmitteln für Dentalsilikone durchgeführt werden. Die zwei Komponenten werden nach dem Absetzen des Injektor-Hebels aus der Doppelkartusche entfernt und durch eine Mischkanüle ersetzt. Anschließend wird die Doppelkartusche in einen Injektor eingesetzt. Durch die Betätigung des Injektor-Hebels werden die beiden Komponenten in Richtung Mischkanüle bewegt. Die Mischkanüle vermischt A- und B-Komponente und die chemische Reaktion zwischen den beiden Komponenten setzt ein.

Mixing

Die Desinfektion des fertiggestellten Positioners kann mit in der Zahnarztpraxis und zahntechnischen Labor gebräuchlichen Desinfektionsmitteln für Dentalsilikone durchgeführt werden. Die zwei Komponenten werden nach dem Absetzen des Injektor-Hebels aus der Doppelkartusche entfernt und durch eine Mischkanüle ersetzt. Anschließend wird die Doppelkartusche in einen Injektor eingesetzt. Durch die Betätigung des Injektor-Hebels werden die beiden Komponenten in Richtung Mischkanüle bewegt. Die Mischkanüle vermischt A- und B-Komponente und die chemische Reaktion zwischen den beiden Komponenten setzt ein.

Cleaning / disinfecting

Die Desinfektion des fertiggestellten Positioners kann mit in der Zahnarztpraxis und zahntechnischen Labor gebräuchlichen Desinfektionsmitteln für Dentalsilikone durchgeführt werden. Die zwei Komponenten werden nach dem Absetzen des Injektor-Hebels aus der Doppelkartusche entfernt und durch eine Mischkanüle ersetzt. Anschließend wird die Doppelkartusche in einen Injektor eingesetzt. Durch die Betätigung des Injektor-Hebels werden die beiden Komponenten in Richtung Mischkanüle bewegt. Die Mischkanüle vermischt A- und B-Komponente und die chemische Reaktion zwischen den beiden Komponenten setzt ein.

Uso previsto

Die Desinfektion des fertiggestellten Positioners kann mit in der Zahnarztpraxis und zahntechnischen Labor gebräuchlichen Desinfektionsmitteln für Dentalsilikone durchgeführt werden. Die zwei Komponenten werden nach dem Absetzen des Injektor-Hebels aus der Doppelkartusche entfernt und durch eine Mischkanüle ersetzt. Anschließend wird die Doppelkartusche in einen Injektor eingesetzt. Durch die Betätigung des Injektor-Hebels werden die beiden Komponenten in Richtung Mischkanüle bewegt. Die Mischkanüle vermischt A- und B-Komponente und die chemische Reaktion zwischen den beiden Komponenten setzt ein.

Die Desinfektion des fertiggestellten Positioners kann mit in der Zahnarztpraxis und zahntechnischen Labor gebräuchlichen Desinfektionsmitteln für Dentalsilikone durchgeführt werden. Die zwei Komponenten werden nach dem Absetzen des Injektor-Hebels aus der Doppelkartusche entfernt und durch eine Mischkanüle ersetzt. Anschließend wird die Doppelkartusche in einen Injektor eingesetzt. Durch die Betätigung des Injektor-Hebels werden die beiden Komponenten in Richtung Mischkanüle bewegt. Die Mischkanüle vermischt A- und B-Komponente und die chemische Reaktion zwischen den beiden Komponenten setzt ein.

Contraindication

Die Desinfektion des fertiggestellten Positioners kann mit in der Zahnarztpraxis und zahntechnischen Labor gebräuchlichen Desinfektionsmitteln für Dentalsilikone durchgeführt werden. Die zwei Komponenten werden nach dem Absetzen des Injektor-Hebels aus der Doppelkartusche entfernt und durch eine Mischkanüle ersetzt. Anschließend wird die Doppelkartusche in einen Injektor eingesetzt. Durch die Betätigung des Injektor-Hebels werden die beiden Komponenten in Richtung Mischkanüle bewegt. Die Mischkanüle vermischt A- und B-Komponente und die chemische Reaktion zwischen den beiden Komponenten setzt ein.

Contra-indication

Die Desinfektion des fertiggestellten Positioners kann mit in der Zahnarztpraxis und zahntechnischen Labor gebräuchlichen Desinfektionsmitteln für Dentalsilikone durchgeführt werden. Die zwei Komponenten werden nach dem Absetzen des Injektor-Hebels aus der Doppelkartusche entfernt und durch eine Mischkanüle ersetzt. Anschließend wird die Doppelkartusche in einen Injektor eingesetzt. Durch die Betätigung des Injektor-Hebels werden die beiden Komponenten in Richtung Mischkanüle bewegt. Die Mischkanüle vermischt A- und B-Komponente und die chemische Reaktion zwischen den beiden Komponenten setzt ein.

Contre-indication

Die Desinfektion des fertiggestellten Positioners kann mit in der Zahnarztpraxis und zahntechnischen Labor gebräuchlichen Desinfektionsmitteln für Dentalsilikone durchgeführt werden. Die zwei Komponenten werden nach dem Absetzen des Injektor-Hebels aus der Doppelkartusche entfernt und durch eine Mischkanüle ersetzt. Anschließend wird die Doppelkartusche in einen Injektor eingesetzt. Durch die Betätigung des Injektor-Hebels werden die beiden Komponenten in Richtung Mischkanüle bewegt. Die Mischkanüle vermischt A- und B-Komponente und die chemische Reaktion zwischen den beiden Komponenten setzt ein.

Contraindication

Die Desinfektion des fertiggestellten Positioners kann mit in der Zahnarztpraxis und zahntechnischen Labor gebräuchlichen Desinfektionsmitteln für Dentalsilikone durchgeführt werden. Die zwei Komponenten werden nach dem Absetzen des Injektor-Hebels aus der Doppelkartusche entfernt und durch eine Mischkanüle ersetzt. Anschließend wird die Doppelkartusche in einen Injektor eingesetzt. Durch die Betätigung des Injektor-Hebels werden die beiden Komponenten in Richtung Mischkanüle bewegt. Die Mischkanüle vermischt A- und B-Komponente und die chemische Reaktion zwischen den beiden Komponenten setzt ein.

Contra-indication

Die Desinfektion des fertiggestellten Positioners kann mit in der Zahnarztpraxis und zahntechnischen Labor gebräuchlichen Desinfektionsmitteln für Dentalsilikone durchgeführt werden. Die zwei Komponenten werden nach dem Absetzen des Injektor-Hebels aus der Doppelkartusche entfernt und durch eine Mischkanüle ersetzt. Anschließend wird die Doppelkartusche in einen Injektor eingesetzt. Durch die Betätigung des Injektor-Hebels werden die beiden Komponenten in Richtung Mischkanüle bewegt. Die Mischkanüle vermischt A- und B-Komponente und die chemische Reaktion zwischen den beiden Komponenten setzt ein.

Contraindication

Die Desinfektion des fertiggestellten Positioners kann mit in der Zahnarztpraxis und zahntechnischen Labor gebräuchlichen Desinfektionsmitteln für Dentalsilikone durchgeführt werden. Die zwei Komponenten werden nach dem Absetzen des Injektor-Hebels aus der Doppelkartusche entfernt und durch eine Mischkanüle ersetzt. Anschließend wird die Doppelkartusche in einen Injektor eingesetzt. Durch die Betätigung des Injektor-Hebels werden die beiden Komponenten in Richtung Mischkanüle bewegt. Die Mischkanüle vermischt A- und B-Komponente und die chemische Reaktion zwischen den beiden Komponenten setzt ein.

Die Desinfektion des fertiggestellten Positioners kann mit in der Zahnarztpraxis und zahntechnischen Labor gebräuchlichen Desinfektionsmitteln für Dentalsilikone durchgeführt werden. Die zwei Komponenten werden nach dem Absetzen des Injektor-Hebels aus der Doppelkartusche entfernt und durch eine Mischkanüle ersetzt. Anschließend wird die Doppelkartusche in einen Injektor eingesetzt. Durch die Betätigung des Injektor-Hebels werden die beiden Komponenten in Richtung Mischkanüle bewegt. Die Mischkanüle vermischt A- und B-Komponente und die chemische Reaktion zwischen den beiden Komponenten setzt ein.

Contraindication

Die Desinfektion des fertiggestellten Positioners kann mit in der Zahnarztpraxis und zahntechnischen Labor gebräuchlichen Desinfektionsmitteln für Dentalsilikone durchgeführt werden. Die zwei Komponenten werden nach dem Absetzen des Injektor-Hebels aus der Doppelkartusche entfernt und durch eine Mischkanüle ersetzt. Anschließend wird die Doppelkartusche in einen Injektor eingesetzt. Durch die Betätigung des Injektor-Hebels werden die beiden Komponenten in Richtung Mischkanüle bewegt. Die Mischkanüle vermischt A- und B-Komponente und die chemische Reaktion zwischen den beiden Komponenten setzt ein.

Contra-indication

Die Desinfektion des fertiggestellten Positioners kann mit in der Zahnarztpraxis und zahntechnischen Labor gebräuchlichen Desinfektionsmitteln für Dentalsilikone durchgeführt werden. Die zwei Komponenten werden nach dem Absetzen des Injektor-Hebels aus der Doppelkartusche entfernt und durch eine Mischkanüle ersetzt. Anschließend wird die Doppelkartusche in einen Injektor eingesetzt. Durch die Betätigung des Injektor-Hebels werden die beiden Komponenten in Richtung Mischkanüle bewegt. Die Mischkanüle vermischt A- und B-Komponente und die chemische Reaktion zwischen den beiden Komponenten setzt ein.

Contraindication

Die Desinfektion des fertiggestellten Positioners kann mit in der Zahnarztpraxis und zahntechnischen Labor gebräuchlichen Desinfektionsmitteln für Dentalsilikone durchgeführt werden. Die zwei Komponenten werden nach dem Absetzen des Injektor-Hebels aus der Doppelkartusche entfernt und durch eine Mischkanüle ersetzt. Anschließend wird die Doppelkartusche in einen Injektor eingesetzt. Durch die Betätigung des Injektor-Hebels werden die beiden Komponenten in Richtung Mischkanüle bewegt. Die Mischkanüle vermischt A- und B-Komponente und die chemische Reaktion zwischen den beiden Komponenten setzt ein.

Contra-indication

Die Desinfektion des fertiggestellten Positioners kann mit in der Zahnarztpraxis und zahntechnischen Labor gebräuchlichen Desinfektionsmitteln für Dentalsilikone durchgeführt werden. Die zwei Komponenten werden nach dem Absetzen des Injektor-Hebels aus der Doppelkartusche entfernt und durch eine Mischkanüle ersetzt. Anschließend wird die Doppelkartusche in einen Injektor eingesetzt. Durch die Betätigung des Injektor-Hebels werden die beiden Komponenten in Richtung Mischkanüle bewegt. Die Mischkanüle vermischt A- und B-Komponente und die chemische Reaktion zwischen den beiden Komponenten setzt ein.

Contraindication

Die Desinfektion des fertiggestellten Positioners kann mit in der Zahnarztpraxis und zahntechnischen Labor gebräuchlichen Desinfektionsmitteln für Dentalsilikone durchgeführt werden. Die zwei Komponenten werden nach dem Absetzen des Injektor-Hebels aus der Doppelkartusche entfernt und durch eine Mischkanüle ersetzt. Anschließend wird die Doppelkartusche in einen Injektor eingesetzt. Durch die Betätigung des Injektor-Hebels werden die beiden Komponenten in Richtung Mischkanüle bewegt. Die Mischkanüle vermischt A- und B-Komponente und die chemische Reaktion zwischen den beiden Komponenten setzt ein.

Contraindication

Die Desinfektion des fertiggestellten Positioners kann mit in der Zahnarztpraxis und zahntechnischen Labor gebräuchlichen Desinfektionsmitteln für Dentalsilikone durchgeführt werden. Die zwei Komponenten werden nach dem Absetzen des Injektor-Hebels aus der Doppelkartusche entfernt und durch eine Mischkanüle erset